

800-278-9947

cr.glidewell dental.com • mail@glidewell dental.cr

COLOR N.º _____

DIENTE N.º _____

MUÑÓN N.º _____

(Se requiere para BruxZir Anterior y IPS e.max)



DISEÑO DE PÓNTICO



CARACTERIZACIÓN OCLUSAL

- Ninguno Claro* Mediano Oscuro

TODO PORCELANA

- BruxZir Full-Strength* (1,150 MPa)
 BruxZir Anterior (650 MPa)
 IPS e.max

PORCELANA A METAL

- No precioso* Semi precioso

DISEÑO DEL METAL PARA ANTERIORES




Nombre del profesional _____ Teléfono _____

Cta. N.º _____ Nombre del paciente _____
Nombre Apellido

Dirección/Correo electrónico _____ Entregar [Ver los Tiempos de Trabajo en el Reverso](#)

Se incluyen con el caso: Impresiones Modelos Mordida Fotos Otro: Pruebas: Sí No

RX INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS *NOTA: Enviar un modelo de estudio para todos los trabajos que involucren dientes anteriores*

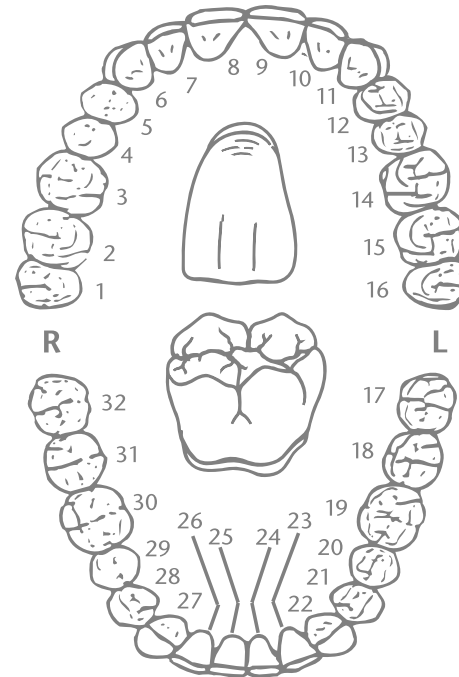

Pegar etiqueta de seguimiento de guía aérea aquí

SI NO HAY ESPACIO INTEROCCLUSAL

- Llamar al doctor
 Desgastar el antagonista
 Oclusión en metal
 Isla metálica
 Agregar como preferencia

Firma _____

(ver detalles de garantía limitada en el reverso)

Licencia N.º _____

INSTRUCCIÓN PARA MARGEN BUCAL

- Margen de unión metal-porcelana*
 Margen de porcelana

DISEÑO DEL METAL POSTERIOR

- Cobertura total de porcelana
 Porcelana con margen metálico lingual*
 Margen ultrafino o de _____ mm, 360°
 Metal oclusal sin cúspide bucal
 Metal oclusal con cúspide bucal

FÉRULAS DE MORDIDA

- Superior* Inferior
 Ferula para bruxismo Comfort H/S* (rígida/blanda)
Opciones de color:
 Transparente* Azul Verde Rosa
 Ferula para bruxismo (rígida)
Opciones de color:
 Transparente* Turquesa
 Ferula para bruxismo blanda

TIEMPOS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO

Tiempo de trabajo en el laboratorio es independiente para cada producto. Los tiempos de trabajo **NO** están garantizados y **NO** incluyen fines de semana ni feriados.

Servicios de corona y puente.....7 días en el laboratorio

BruXzir Solid Zirconia/IPS e.max5 días en el laboratorio

Férulas para bruxismo2 días en el laboratorio

Para programar la recolección del caso en el consultorio, llamar al **800-278-9947**.


INFORMACIÓN DE TÉRMINOS Y GARANTÍA

Aceptamos las tarjetas de crédito VISA, MASTERCARD, AMEX y DISCOVER.


TÉRMINOS: Todas las cuentas se deben pagar dentro de los 15 días de la fecha del resumen de cuenta. **Las cuentas que no fueran pagadas dentro de los plazos establecidos serán consideradas COD y se les aplicará un cargo por mora del 2 por ciento sobre el saldo impago.** Los precios pueden ser modificados sin previo aviso. Se debe adjuntar la receta con el envío del estuche original.

GARANTÍA LIMITADA/LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Glidewell Costa Rica ("el laboratorio") garantiza que todos los dispositivos dentales ("dispositivo") se elaboran de conformidad con sus especificaciones y aprobación con el convencimiento de que el dispositivo será útil y **NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ENTRE ELLAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO.** Sujeto a la devolución de un dispositivo que presenta fallas una vez colocado, el laboratorio reparará o reemplazará el dispositivo sin cargo por el costo del material y la mano de obra o bien reintegrará el precio original pagado, a opción del laboratorio, según se indica a continuación: (1) pilares de implantes atornillados hasta 20 años (que incluye el reemplazo de un dispositivo fabricado por el laboratorio y fijado a dichos pilares que incluye un implante dental Inclusive® Tapered (cónico) de titanio a pedido sin cargo adicional); (2) prótesis de porcelana sobre metal, solo de cerámica, solo de metal tipo inlay, outlay de una sola pieza y corona definitiva de compuesto de resina, y coronas atornilladas y barras de implante, hasta siete años; (3) puentes de compuesto de resina (a excepción de los puentes Maryland e inlay/onlay) hasta cinco años, (4) placas y férulas termoformadas en el caso de que la falla se deba a defectos del material o la mano de obra, prótesis provisionarias, puentes de compuesto de resina Maryland e inlay/outlay hasta seis meses; (5) todos los demás dispositivos hasta 30 días si la falla se debe a defectos del material o la mano de obra. Esta garantía es exclusiva para su beneficio, no es transferible y no se extiende a los pacientes. Usted se compromete a pagar todos los demás costos de ajuste, reparación y reemplazo de un dispositivo. A excepción de lo prohibido expresamente por la ley, el laboratorio **NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS RELACIONADOS CON EL USO DE UN DISPOSITIVO, SEAN ESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS O CONSECUENTES,** sea cual fuere la teoría invocada, entre ellas, de garantía, contractual, de negligencia o de responsabilidad estricta, y en los casos en que esta exención de responsabilidad no esté permitida por la ley, la duración de la garantía implícita se limita a 90 días contados a partir de la fecha de entrega. En caso de controversia y ante la imposibilidad de una solución amigable, las partes acuerdan renunciar a las demandas colectivas en favor de un arbitraje individual obligatorio de todos los reclamos que surjan respecto de esta garantía de conformidad con las leyes del estado de Costa Rica. El laboratorio no garantiza el desempeño de transportistas independientes.

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN

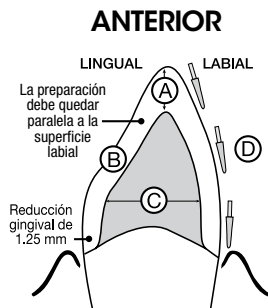

- A. Reducción incisal de 2 mm
- B. Reducción del tercio medio de 1.5 mm
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos.

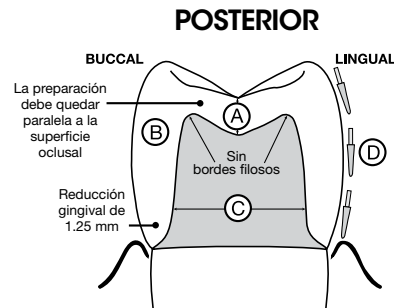

- A. Reducción incisal de 2 mm
- B. Reducción del tercio medio de 1.5 mm
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos

USO EXCLUSIVO DE GLIDEWELL COSTA RICA
REGISTRO DE LLAMADA TELEFÓNICA

DR. _____ CTA. N.º _____

NOMBRE DEL PACIENTE _____

RE: _____

RESULTADO _____

FECHA LÍMITE EN CONSULTORIO _____

FECHA DE LA LLAMADA _____ INICIALES _____



DENTISTAS: No se aplicará ningún cargo por una recolección y una entrega por caso.

A los envíos adicionales para rasurar, pruebas de bizcocho, pruebas de estructura, cambios de color y articuladores sobredimensionados se les aplicará un cargo de €2000/\$4 por caja.